



THS879-30-
ISO7206-3

Gliding nail fatigue test.
lower part with bath and holder
Stainless steel
sealing
Confirm to ISO 7206 Figure 3
Upper part free moving

Die Prüfmethode beschreibt die Dauerschwingprüfung von Gleitnägeln. Die Prüfung erfolgt in Anlehnung an ISO 7206-4. Der Gleitmechanismus des Nagels wird dabei über eine Hülse arretiert welche Ihrerseits keinen Einfluß auf die Biegefestigkeit des Implantates ausübt. Standardmäßig werden sechs Implantate geprüft.

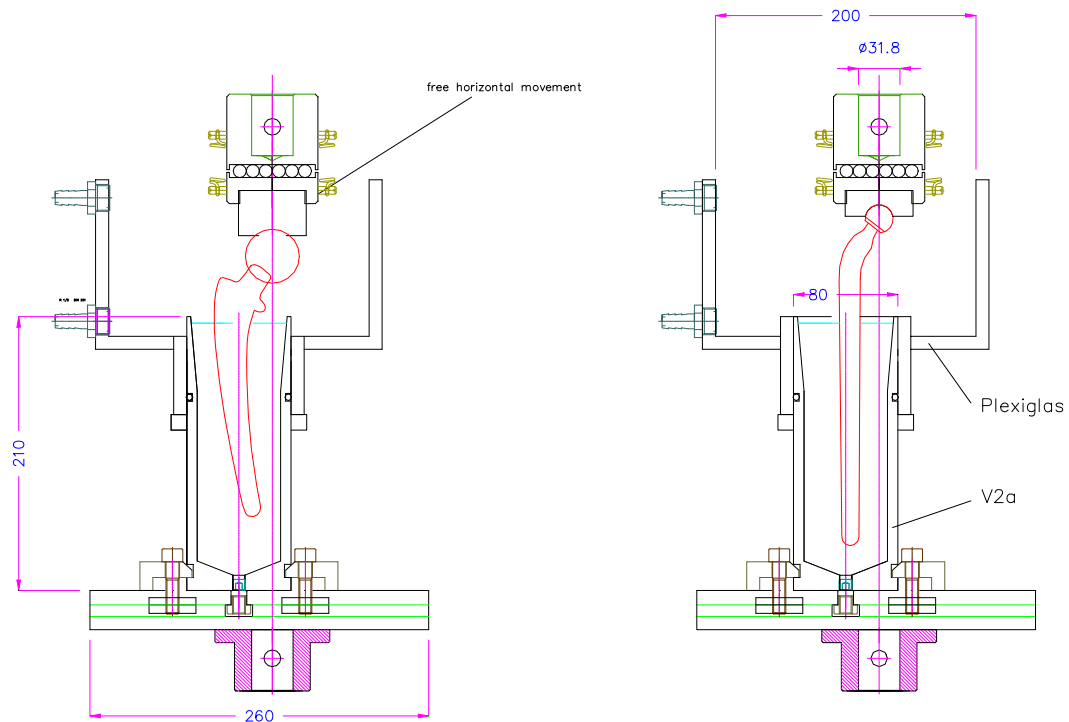

THS879-30-ISO7206

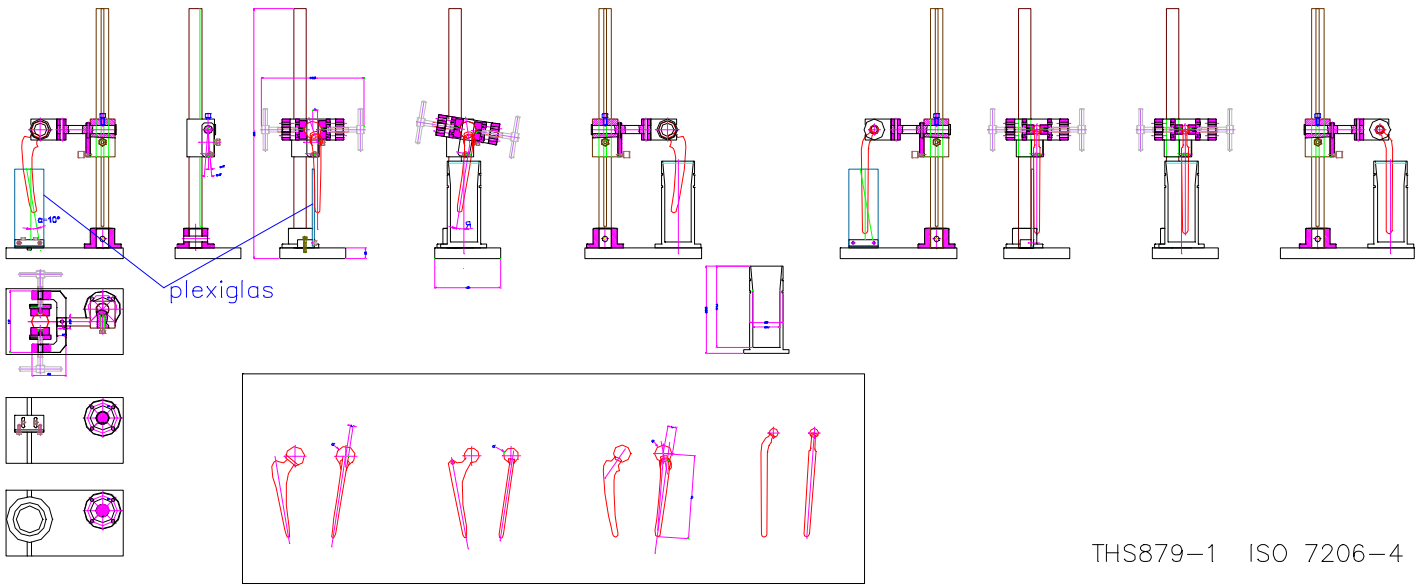

THS879-1 ISO 7206-4

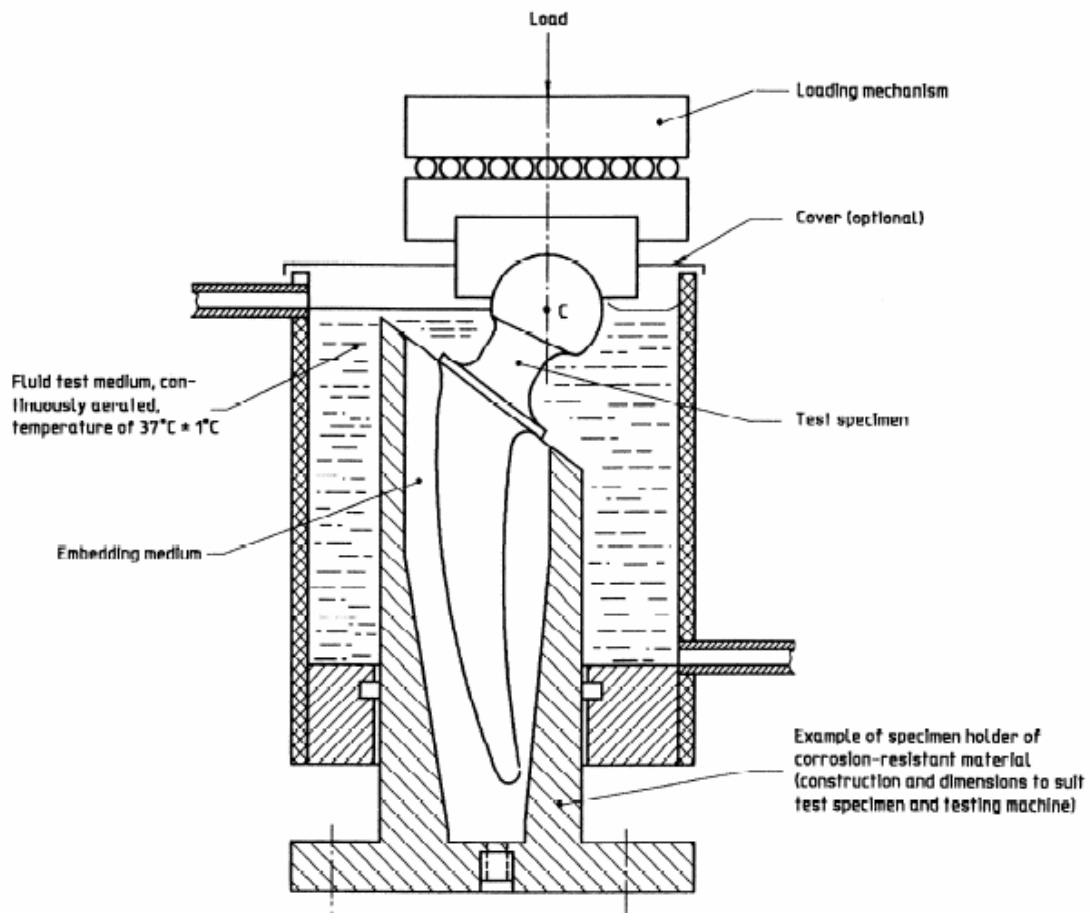


Figure 3 — General arrangement of specimen for testing